

Central 24-2 Teste Limiar

Monitor de Fixação: Fixação/Ponto Cego Estímulo: III, Branco

Diâmetro da Pupila:

Data: 10-03-2025

Alvo de Fixação: Central

Fundo: 31.5 ASB

Acuidade Visual:

Horas: 15:39

Perdas de Fixação: 0/17

Estratégia: SITA-Standard

RX: DS DC X


Idade: 51

Erros Falsos POS: 0 %

Erros Falsos NEG: 10 %

Duração do Teste: 08:19

Fóvea: 31 dB

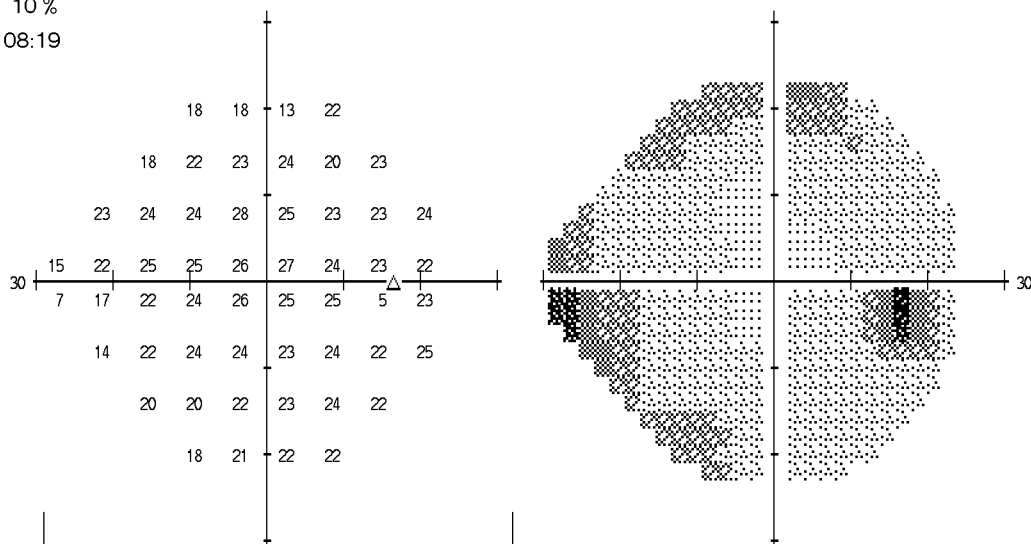

-9	-10	-14	-4				
-11	-7	-6	-6	-9	-5		
-6	-6	-8	-4	-6	-8	-7	-5
-12	-8	-7	-8	-6	-6	-8	-8
-20	-13	-9	-9	-7	-7	-7	
-15	-9	-8	-8	-9	-8	-9	-6
-10	-11	-10	-9	-7	-8		
-11	-9	-8	-8				

	-3	-3	-8	2				
	-5	-1	0	0	-3	1		
	0	0	-1	2	0	-2	-1	1
-6	-2	-1	-2	0	0	-2		-1
-14	-7	-3	-3	-1	-1	-1		-1
	-9	-3	-2	-2	-3	-2	-3	1
		-4	-5	-3	-3	-1	-2	
			-5	-3	-2	-2		

GHT


Fora dos limites normais

VFI 96%


MD -8.14 dB P < 0.5%

PSD 2.44 dB P < 2%

Desvio Total

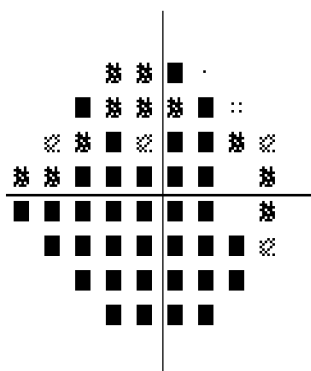

Modelo de Desvio

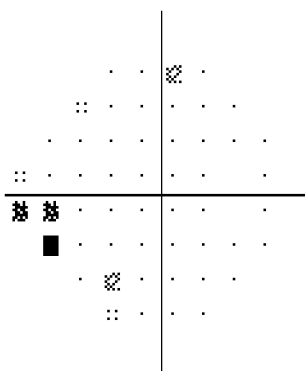

:: < 5%

⊗ < 2%

⊠ < 1%

■ < 0.5%